

Femme de 47 ans



Chute en trottinette



Urgences



Réanimation



Bloc opératoire



Imagerie



Hospitalisation conventionnelle



Rééducation





Chute en trottinette

Mme G. Padibaule, âgée de 47 ans et ayant pour antécédent une insuffisance respiratoire chronique, est tombée en trottinette. Elle présente une fracture ouverte du fibula, se trouve en position antalgique marquée et manifeste une détresse respiratoire aiguë.

Une oxygénothérapie a été mise en place durant le transport en ambulance vers l'hôpital.

Une seule réponse possible, entourez-la !

1. Quel est le principal objectif de l'oxygénothérapie ?

- A) Diminuer l'anxiété
- B) Diminuer le travail respiratoire et améliorer les échanges gazeux
- C) Remplacer complètement la ventilation spontanée
- D) Assurer une sédation profonde

2. Quelle est la complication la plus courante de l'oxygénothérapie ?

- A) Pneumothorax
- B) Inconfort du masque voire brûlures
- C) Hyperalgie
- D) Embolie pulmonaire

3. Quel signe indique un échec de l'oxygénothérapie nécessitant un besoin de ventilation invasive (intubation) ?

- A) Amélioration des échanges gazeux après 1h
- B) Persistance de signes de lutte respiratoire
- C) Diminution de la fréquence respiratoire à 25/min
- D) Augmentation de la SpO₂ à 92% sous VNI





Urgences

À son arrivée aux urgences, Mme G. Padibaule présente un choc hémorragique dû à sa fracture ouverte nécessitant la pose d'un cathéter veineux central.



Caractéristiques	MIDLINE	PICCLINE	VVC	CCI
Voie				
Durée d'utilisation				
Lieu d'insertion				
Utilisation de médicaments irritants / vésicants				
Images				

Remplissez le tableau en collant les propositions au bon endroit...



Imagerie

Une seule réponse possible, entourez-la !

Mme G. Padibaule dans sa chute a fait un pneumothorax traumatique. Après une intubation orotrachéale, un scanner thoracique doit être fait d'urgence.

1. Quel est l'objectif principal de la réalisation d'un scanner thoracique en cas de suspicion de pneumothorax traumatique ?

- A) Visualiser les fractures osseuses associées
- B) Confirmer la présence et la localisation du pneumothorax
- C) Évaluer la perfusion pulmonaire
- D) Déterminer le type de gaz dans le pneumothorax

2. Un scanner est un :

- A) DM de classe I
- B) DMDIV
- C) DM implantable actif
- D) DM de classe IIb

3. Quel événement doit obligatoirement être signalé en matériovigilance concernant un scanner ?

- A) Une panne de l'imprimante connectée
- B) Un retard de 10 minutes dans le protocole
- C) Une irradiation excessive due à un mauvais réglage
- D) L'utilisation d'un scanner en dehors des heures normales






Bloc opératoire





Il s'agit d'un pneumothorax stable nécessitant une surveillance rapprochée. Mme G. Padibaule va pouvoir être opérée de sa fracture de jambe avec pose d'un fixateur externe.

Trouvez les différences :

- A. L'image comporte 4 différences
- B. L'image comporte 5 différences
- C. L'image comporte 6 différences
- D. L'image comporte 7 différences

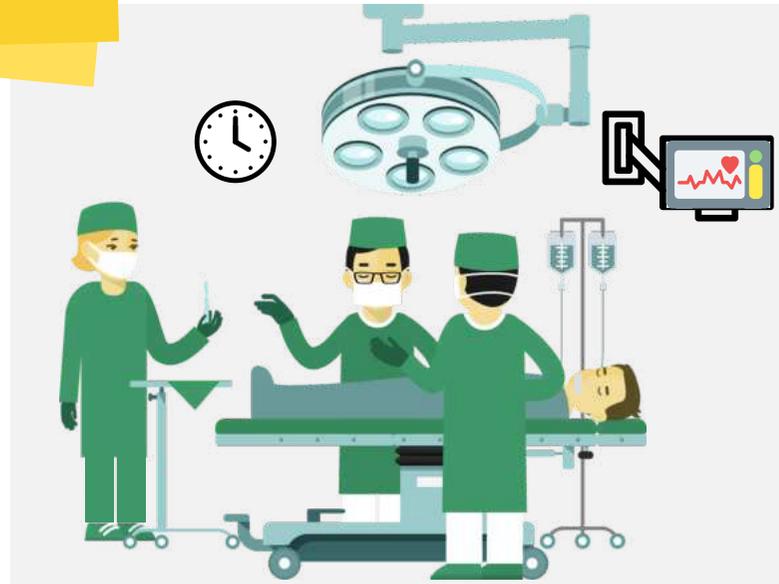

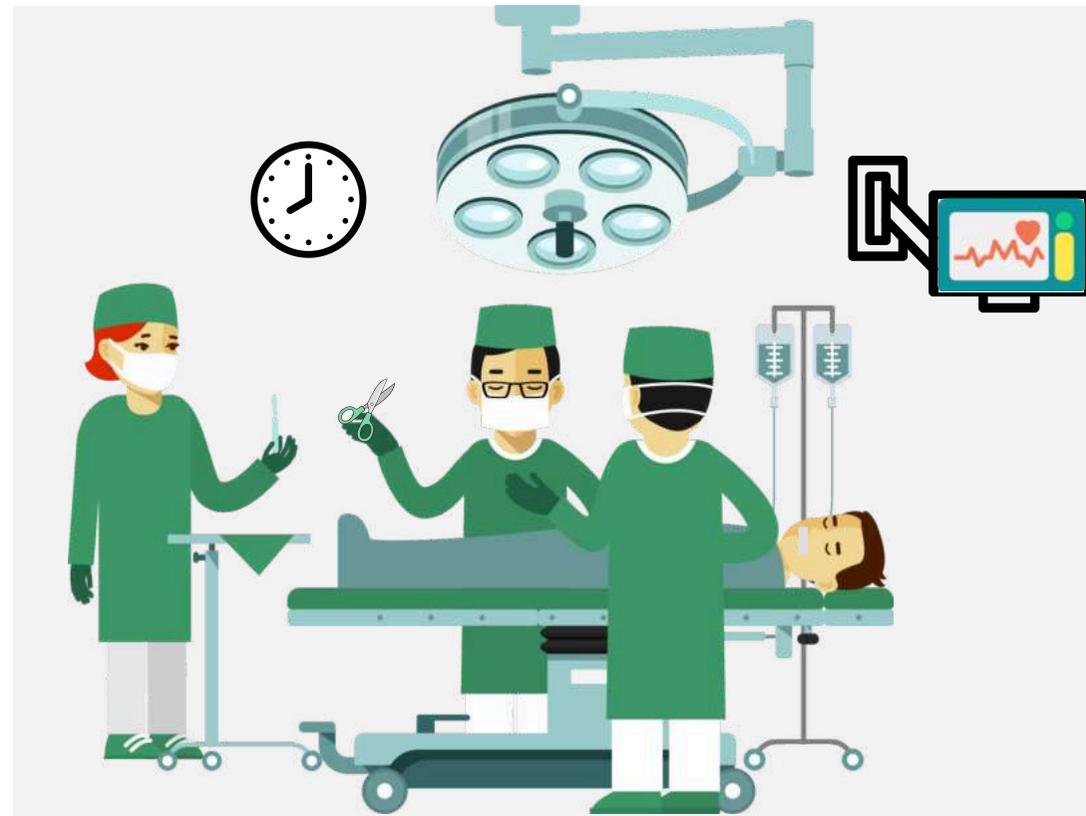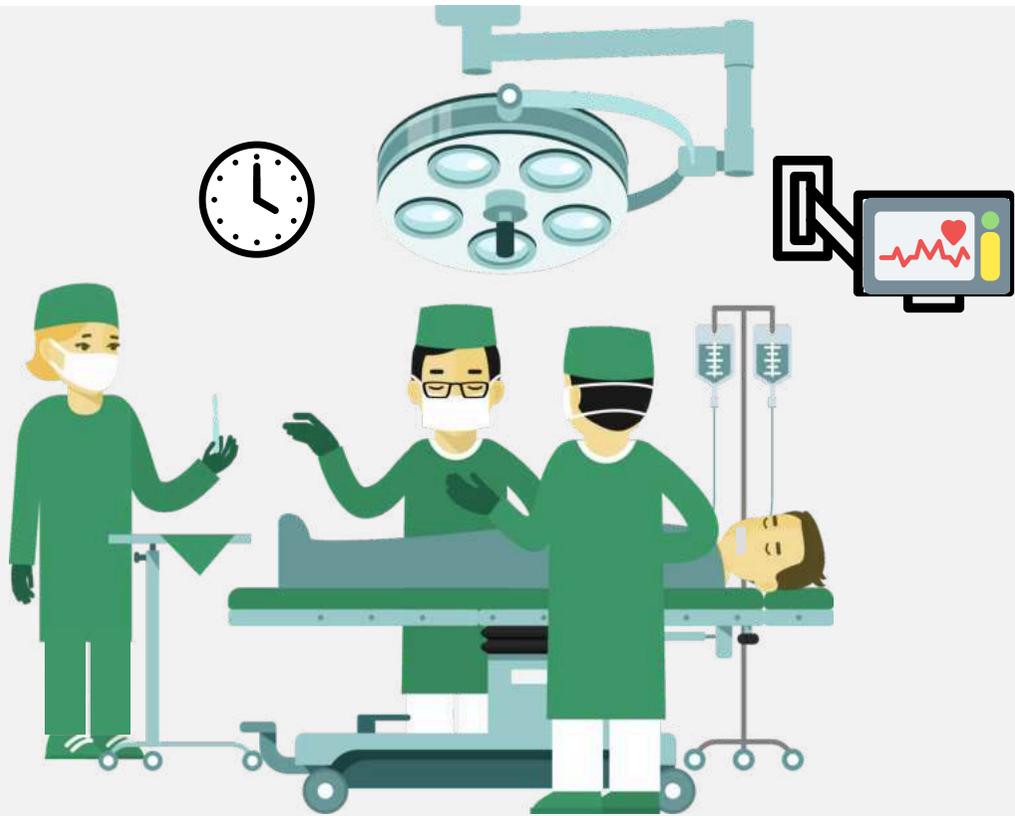



Réanimation

L'opération s'est bien déroulée,
Mme G. Padibaule est transférée en
réanimation pour surveillance.

Une seule réponse possible, entourez-la !

1. Quel événement doit être obligatoirement signalé en réanimation en matériovigilance ?

- A) Un mauvais positionnement de lit
- B) Une désaturation du patient due à une déconnexion non signalée du ventilateur
- C) Une rupture de stock de gant stérile
- D) Un changement d'équipe de garde


2. Parmi ces paramètres, lequel est le plus critique à surveiller en réanimation ?

- A) La sédation
- B) La saturation en oxygène
- C) La douleur
- D) La fréquence urinaire

3. En cas de pneumothorax stable non drainé, quel est le principal objectif de la surveillance en réanimation ?

- A) Diminuer le risque de septicémie
- B) Vérifier qu'il ne progresse pas vers un pneumothorax compressif
- C) Stimuler la toux pour ré expansion
- D) Prévenir l'embolie pulmonaire



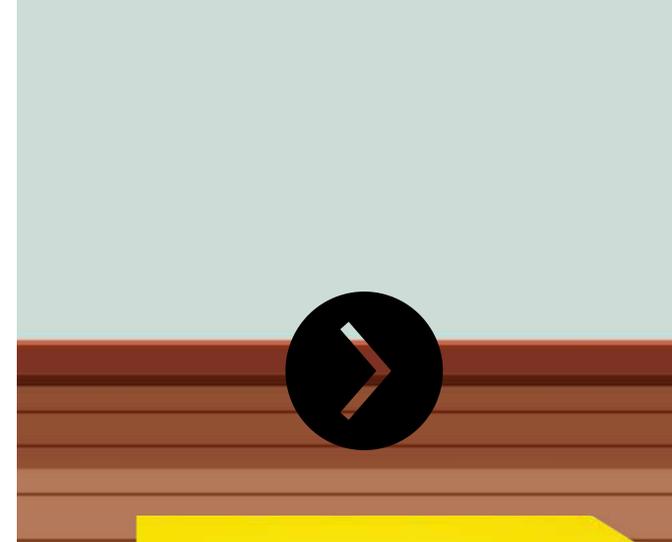

A = Hospitalisation conventionnelle

Après extubation, Mme G. PADIBAULE est transférée en service d'hospitalisation conventionnelle. Elle se plaint de fortes douleurs. La patiente est mise sous morphine, mais les douleurs s'amplifient. Une heure après la pose de la perfusion, l'infirmière constate une énorme flaque au sol malgré la bonne connexion de celle-ci. Cette dernière fait une déclaration de matériovigilance, mais ne renseigne pas la référence de la perfusion.

B = Ce que vous allez demander au service déclarant :


- 1** = Je demande au service de m'envoyer le patient pour lui expliquer qu'il doit aussi réaliser la déclaration de son côté
- 2** = Je demande le contact du médecin généraliste du patient
- 3** = Je demande au service s'il a conservé l'emballage du DM incriminé et si oui de me l'envoyer
- 4** = Je demande le dossier patient
- 5** = J'explique au service que cette déclaration ne sert à rien car seul les évènements avec une conséquence grave nous intéresse.



A (= nombre de lettres du service)



B

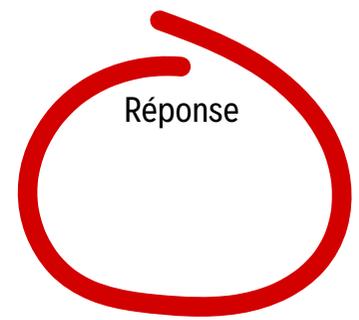



B|BRAUN B|BRAUN B|BRAUN

Original Perfusor® Line
Type : IV-Standard - PE, Luer Lock

2021-01 150 cm
40°C; 2 bar; 0,02 ml

2016-01 GTIN: 04022495079701

LOT 16A16E8SC5

REF 8722935

PZN 06100636

STERILE EO

1113 N0285 0514 1



    CE 0123

 = Pressure (Druck) non-pyrogenic Made in France

B|BRAUN
B. Braun Melsungen AG
34209 Melsungen, Germany



B|BRAUN B|BRAUN B|BRAUN B|BRAUN

Original Perfusor® Line
Type: IV-Standard - PVC

2025-03-01

2020-03-03

LOT 20C03E8SB4

REF 8722960

GTIN04022495001450

STERILE EO

150 cm

VOL 2.1 ml/m (40°C)
2.3 ml/m (40°C, 2bar)

PZN 03814275



      CE 0123

 = Pressure (Druck) Made in France



B. Braun Melsungen AG
34209 Melsungen, Germany



Hospitalisation conventionnelle



Grâce à l'emballage du dispositif médical que vous venez de recevoir, complétez le formulaire de signalement de matériovigilance (Référence commerciale, N° de lot et date d'expiration). Enfin, effectuez l'opération ci-dessous grâce à votre formulaire.

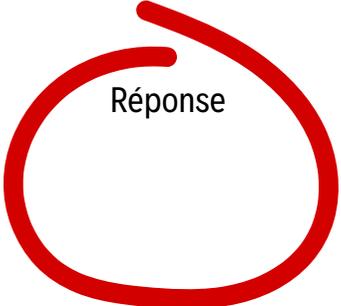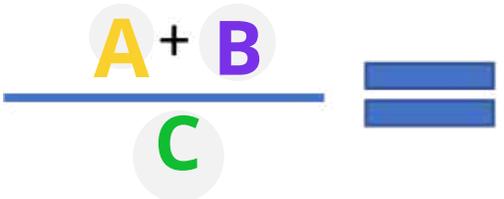

Aide à la déclaration : Modèle de formulaire

Ce modèle vous permet de préparer LA SAISIE EN LIGNE de votre déclaration.

Vous êtes : PROFESSIONNEL_SANTE

Vous souhaitez déclarer : MATERIOVIGILANCE

Vos informations personnelles	
Profession	
Complément profession	
Nom	
Prénom	
Téléphone ou pour les correspondants locaux : Télécopie	
Adresse électronique	
Nom de l'établissement ou de l'organisme	
Adresse postale	
Code postal / Commune	
Êtes-vous le correspondant de matériovigilance ou son suppléant ?	
<small>Si vous êtes dans un établissement de santé, il est préférable de prendre contact avec votre correspondant local de matériovigilance qui a pour rôle de recevoir et transmettre ensuite les déclarations à l'ansm. Sinon, vous pouvez les transmettre à l'ansm vous-même via ce portail.</small>	
Informations sur la personne concernée	
Nom (3 premières lettres)	
Sexe	
Age (réel ou estimé)	
Poids	
Dispositif médical impliqué / Autre matériel 1	
Type de dispositif	Prolongateur
Libellé du produit	Original perfusor® line
Référence commerciale	□□□□□□□□ ← A
Version logicielle	
Fabricant : Nom	B BRAUN

Fabricant : Adresse	
Fournisseur : Nom	
Fournisseur : Adresse	
N° de lot	□□□□□□□□ B
N° de série	
Date de mise en service	
Date d'expiration	□□ - □□ C
Date d'implantation	
Date d'explantation	
Localisation actuelle du dispositif	
Type d'utilisateur du dispositif	
Mode d'utilisation du dispositif	
Si autre, veuillez préciser	
Date et lieu de survenue de l'incident	
Date de survenue	
Période de survenue	
Type de lieu de survenue	
Nom de l'établissement	
Adresse	
Code postal / Commune	
Service	
Personne à contacter dans l'établissement	
Téléphone du contact	
<small>Si autre, préciser (nom de la structure, adresse, coordonnées de la personne à contacter)</small>	
Description de l'incident	
Numéro d'enregistrement interne de la déclaration	
Date d'information du fabricant	
<small>Si l'incident de matériovigilance est en lien avec l'utilisation d'un DM faisant suite à une rupture d'approvisionnement d'un autre DM ou un arrêt de commercialisation, veuillez s'il vous plaît copier-coller la phrase suivante dans le champ description de l'incident ci-dessous : Lien avec rupture d'approvisionnement d'un autre dispositif médical. Veuillez y préciser également les informations suivantes sur le dispositif médical en rupture : libellé du produit en rupture, nom du fabricant, référence et IUD (si connu).</small>	
Description de l'incident	



Rééducation

Mme G. Padibaule commence sa rééducation avec un kinésithérapeute.



Remplissez les mots fléchés. Grâce aux lettres obtenues dans les cases jaunes formez le mot caché (indice : c'est le but de la rééducation)





Mme G. Padibaule est sortie de l'hôpital !
Rassemblez tous les indices reçus afin de
trouver le code du coffre et récupérer
votre récompense.
Attention à l'ordre !

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5

Code secret du coffre :



--	--	--	--	--	--

+

